**Test #28 Chamber ME1.2. .2.005**

2003-4-24 20:55
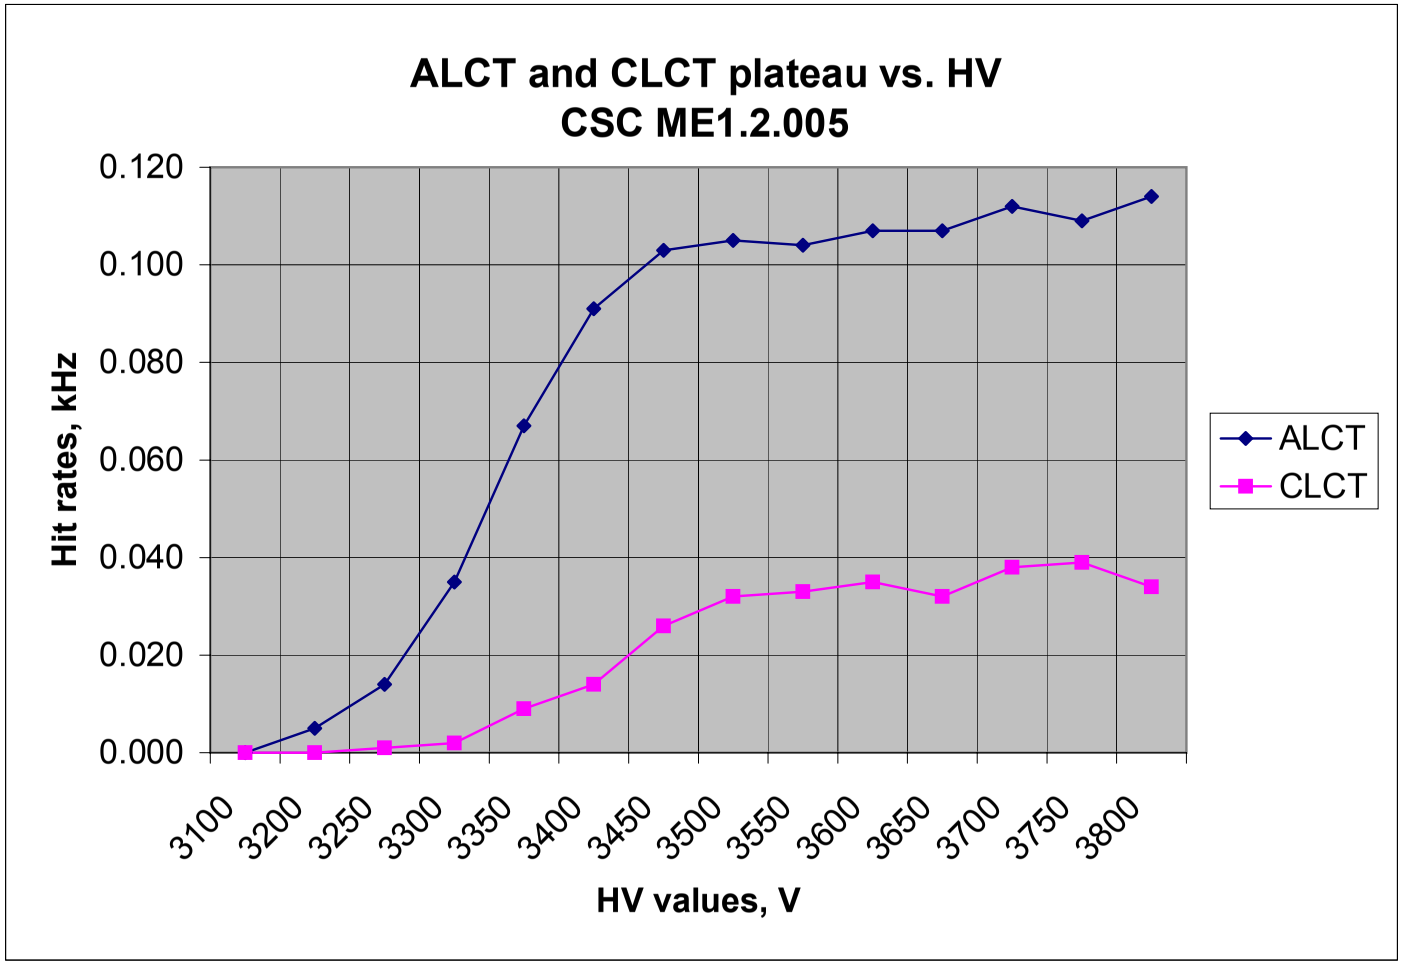
| HV, V | ALCT, kHz | CLCT, k Hz |
|---|---|---|
| 3100 | 0.000 | 0.000 |
| 3200 | 0.005 | 0.000 |
| 3250 | 0.014 | 0.001 |
| 3300 | 0.035 | 0.002 |
| 3350 | 0.067 | 0.009 |
| 3400 | 0.091 | 0.014 |
| 3450 | 0.103 | 0.026 |
| 3500 | 0.105 | 0.032 |
| 3550 | 0.104 | 0.033 |
| 3600 | 0.107 | 0.035 |
| 3650 | 0.107 | 0.032 |
| 3700 | 0.112 | 0.038 |
| 3750 | 0.109 | 0.039 |
| 3800 | 0.114 | 0.034 |