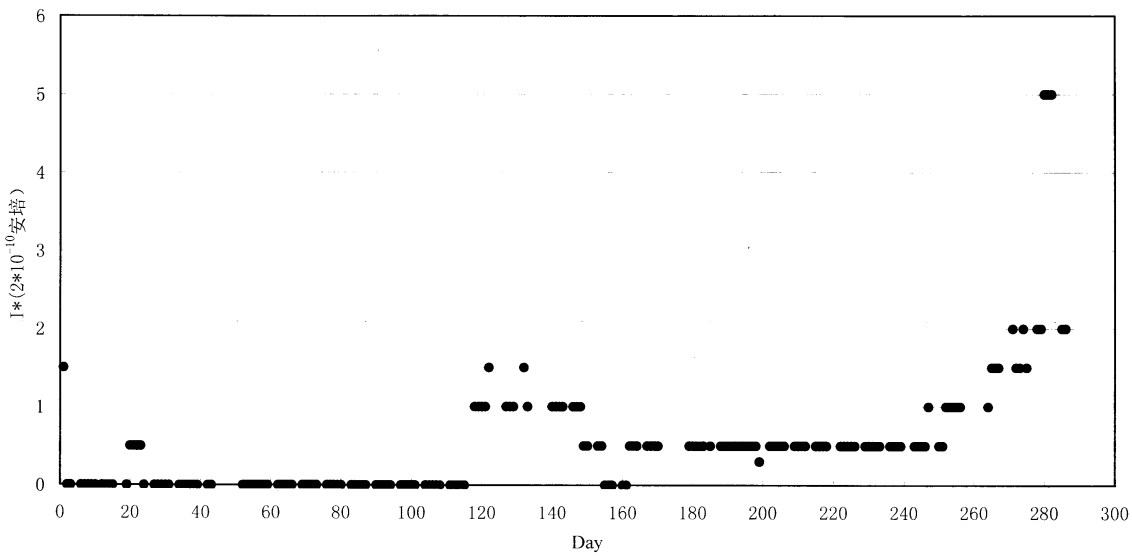MDCIII定位子（30个）漏电流测量
测量时间：1999.8.18--2000.5.30　　HV=4000V
数字检流计：$2*10^{-10}$安培